



Aplikace autologních mezenchymálních kmenových buněk (MSCs) KŮŇ

MVDr. Miroslav Trunda

Produkt mezenchymálních kmenových buněk (MSCs)

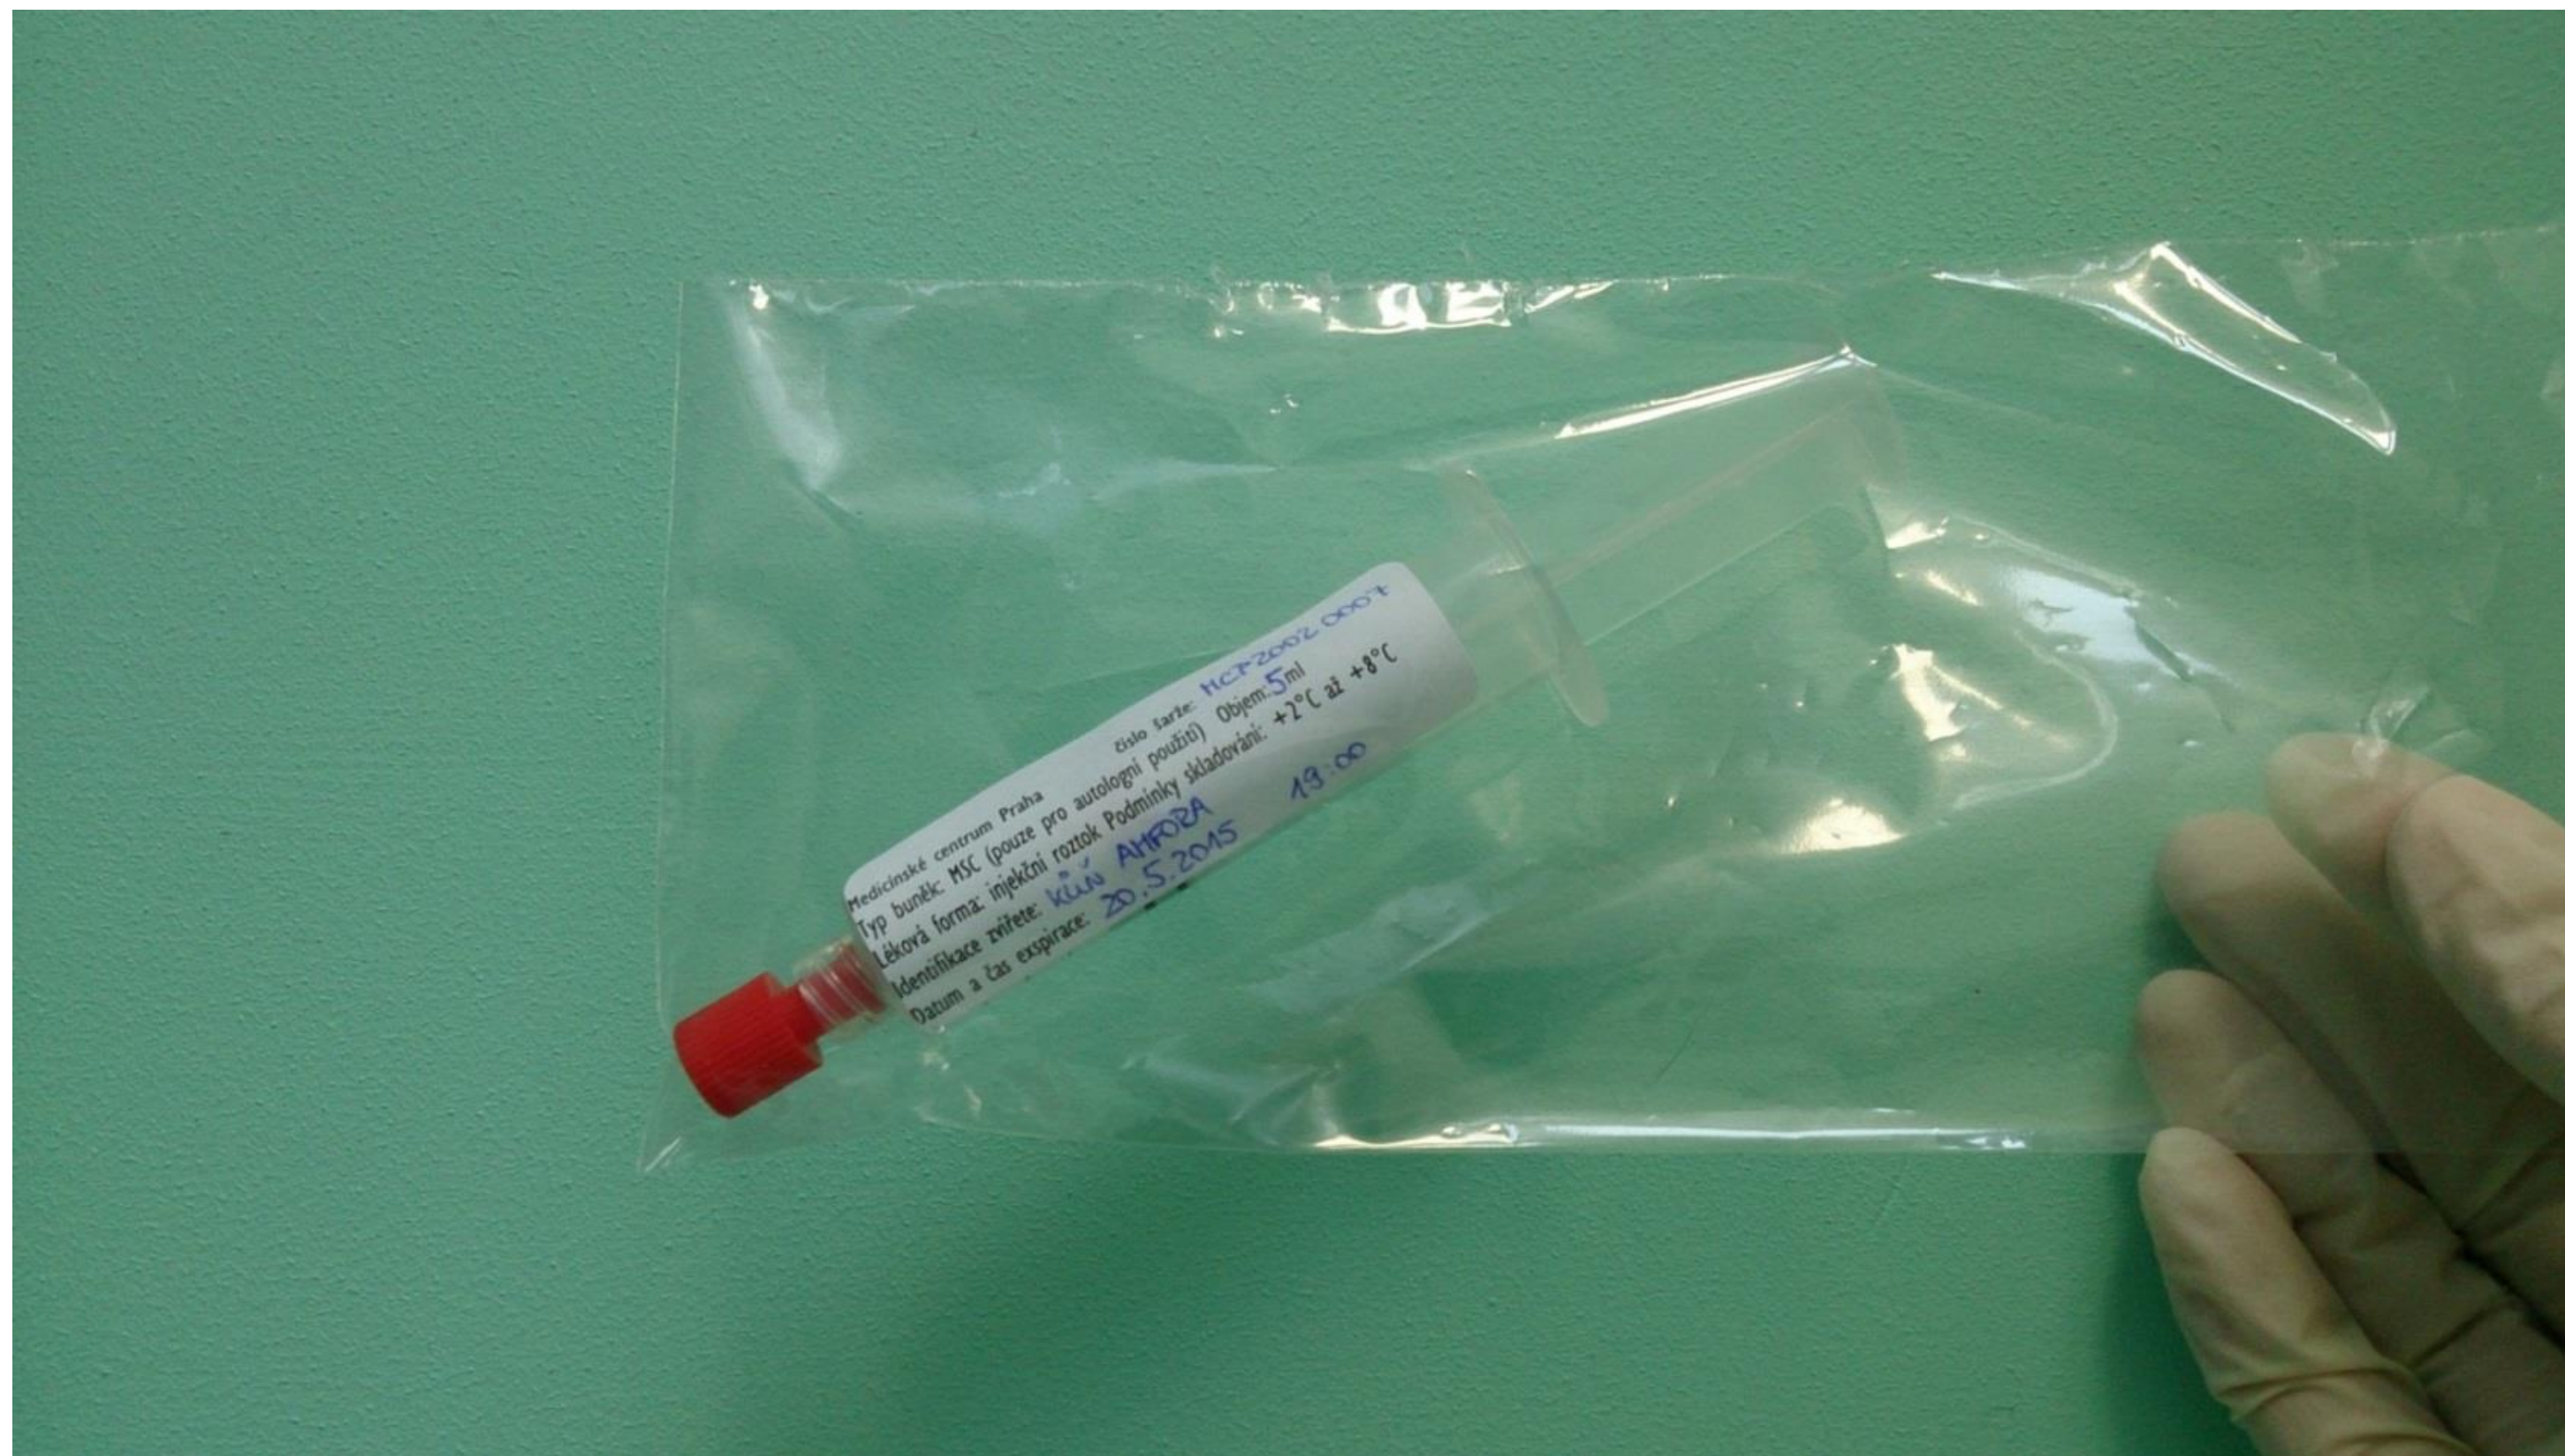

Produkt – injekční stříkačka s mezenchymálními kmenovými buňkami pro autologní použití, označena štítkem s jednoznačným ID, v zataveném sekundárním obalu

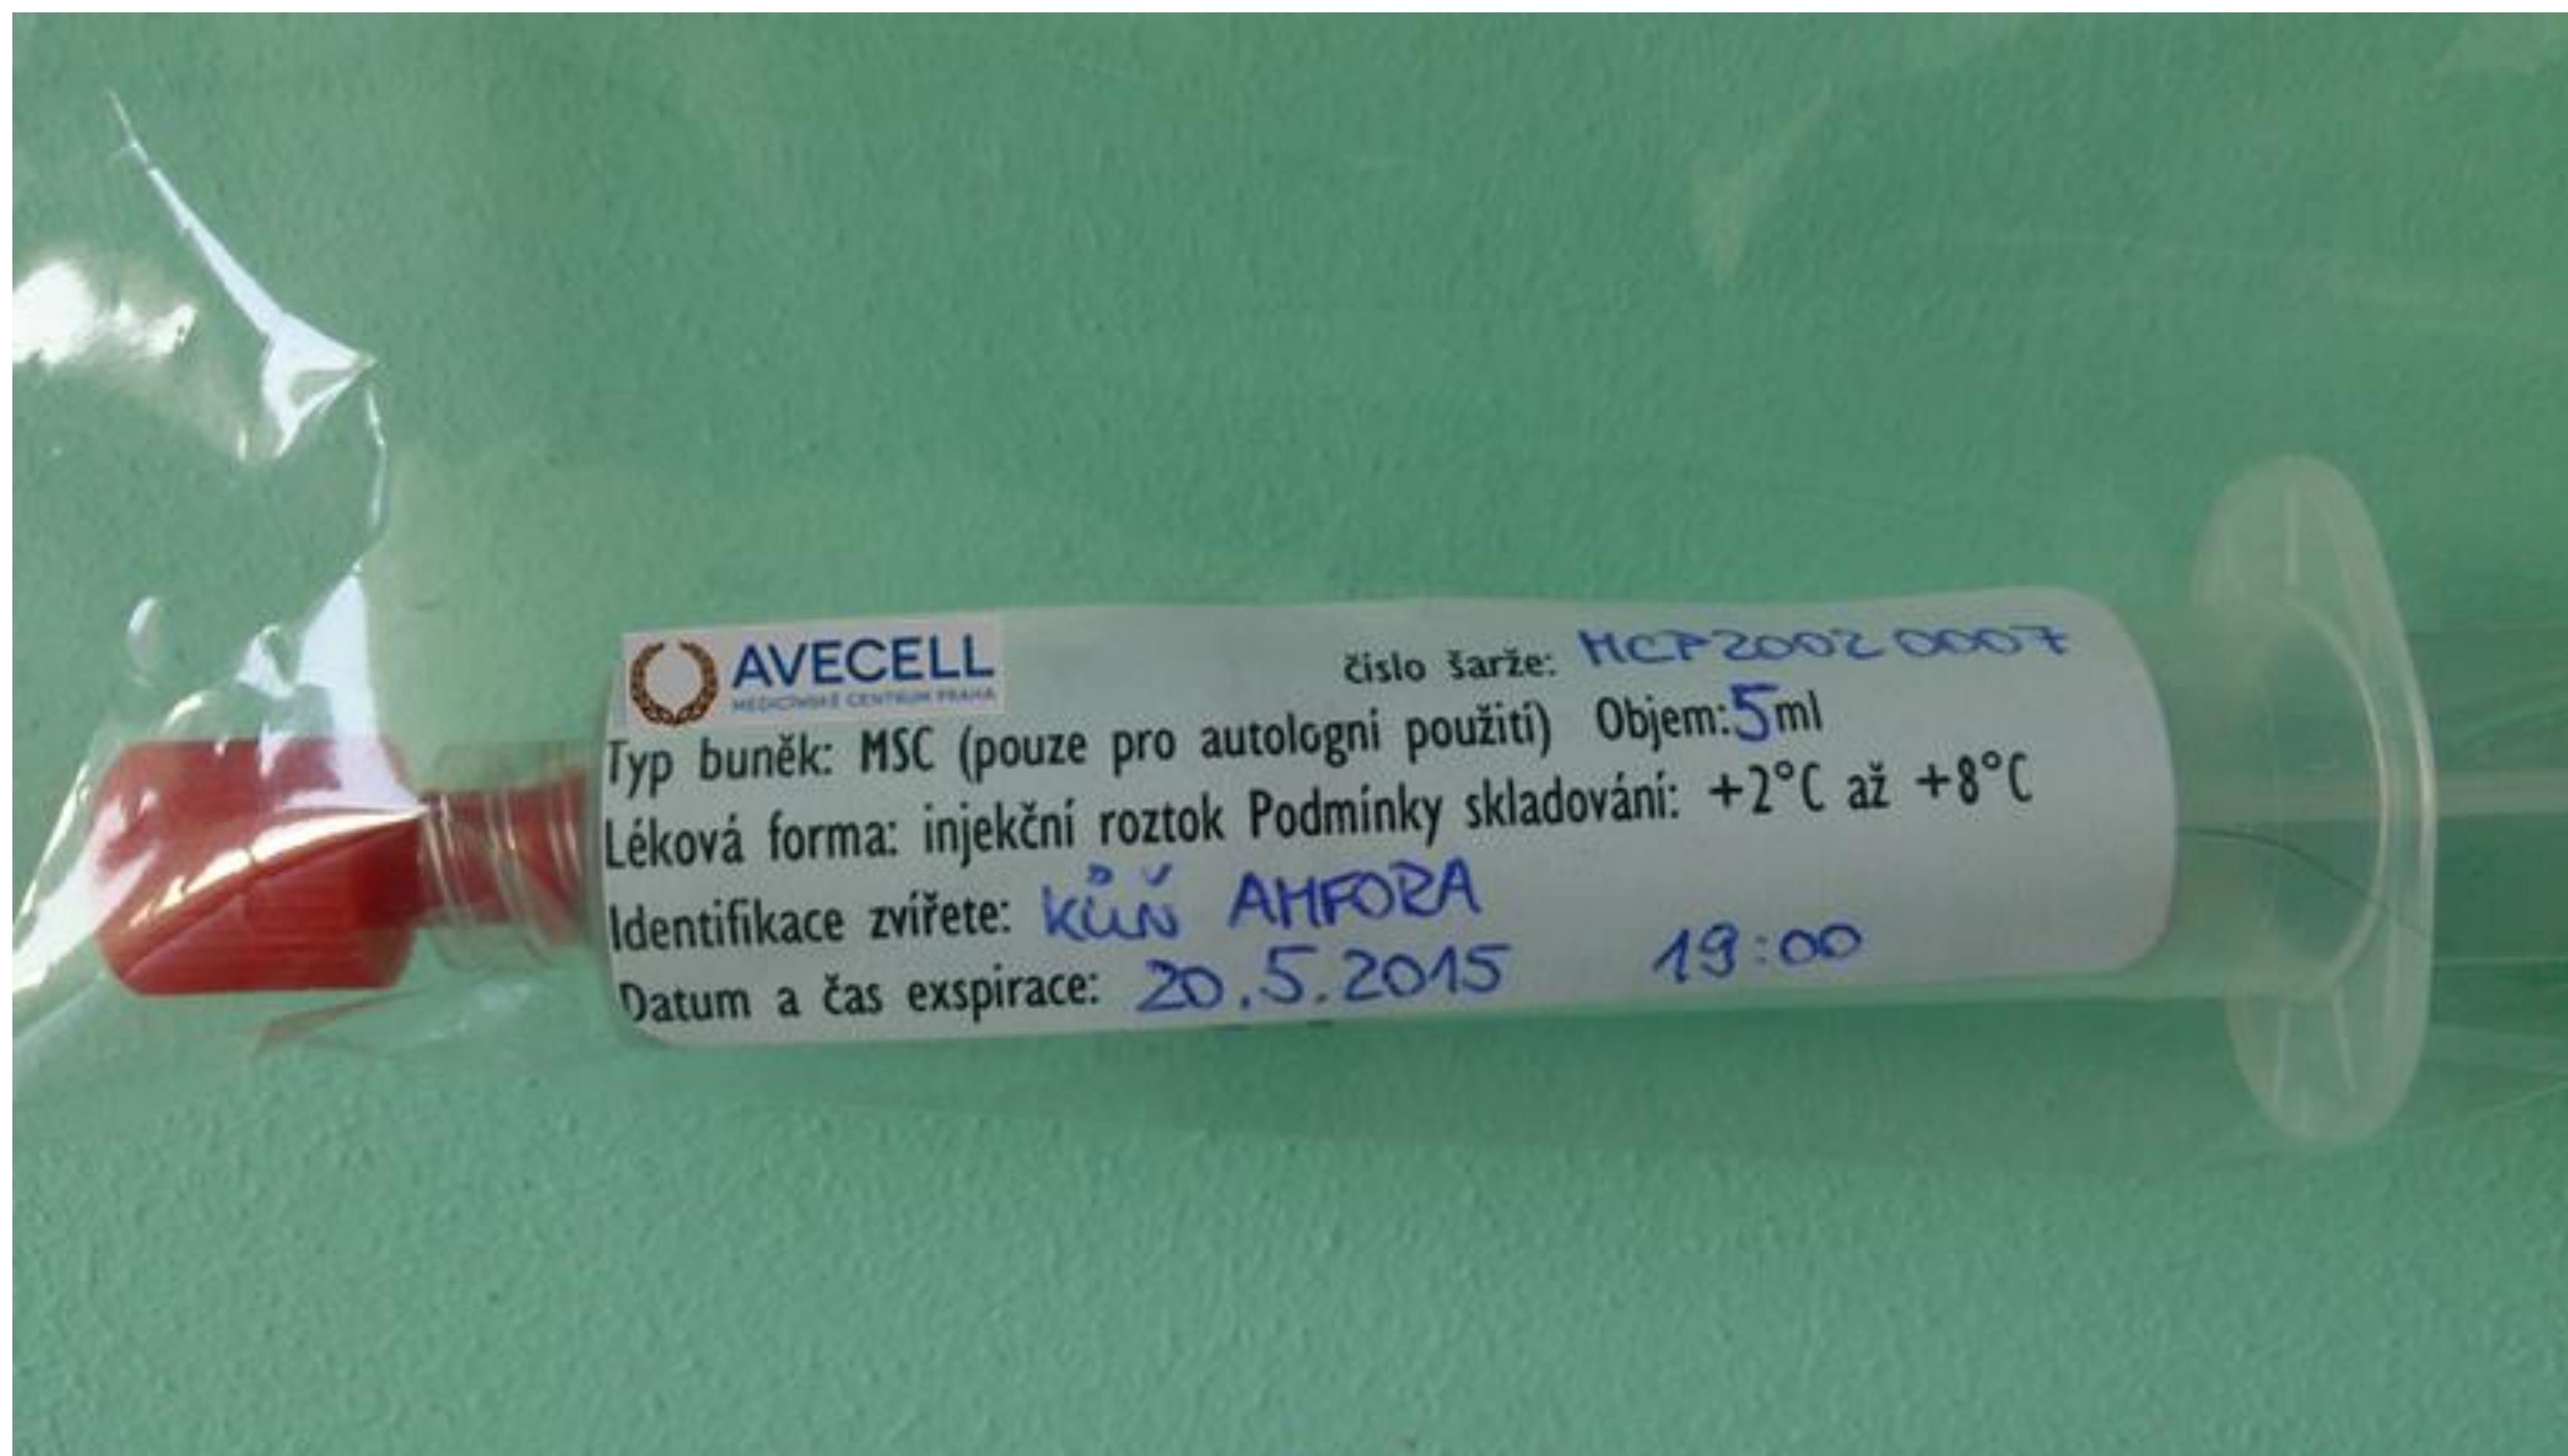

Předávací protokol produktu

- Formulář *Předávací protokol* – při předání produktu obdržíte kopii toho formuláře

Správné uchování produktu do jeho aplikace

- Nachlazený termobox (+2 až +8 °C)
- Zapnutý datalogger; vložen v termoboxu
- Produkt je označen štítkem s jednoznačným ID a uchováván v zataveném sekundárním obalu
- Exspirace produktu: 12 hodin od jeho vydání

Správné uchování produktu do jeho aplikace

veterinární
medicína
avecell



Příbalová informace

- Před podáním produktu čtěte pozorně přiloženou příbalovou informaci.

 AVECELL MEDICÍNSKÉ CENTRUM PRAHA	Příbalová informace buněčného přípravku pro autologní použití Příloha k SOP-V1-05	Mezi Vodami 205/29 143 00 Praha 4 T +420 270 003 562 E info@avec
---	---	---

NÁZEV A ADRESA VÝROBCE AUTOLOGNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK

Medicínské centrum Praha s.r.o., Mezi Vodami 205, 143 00 Praha 4, Modřany

NÁZEV PŘÍPRAVKU

AVECELL
Buněčný přípravek pouze pro autologní použití.

TYP BUNĚK

Mezenchymální kmenové buňky v autologní krevní plazmě.

ČÍSLO ŠARŽE

ID: 2015MCP0007

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

DATUM A ČAS UKONČENÍ DOBY POUŽITELNOSTI

20.5.2015; 19:00 hod.

Doba použitelnosti produktu je 12 hodin.


Buněčný přípravek nesmí být použit po uplynutí doby expirace.

Pouze pro autologní použití.

Klinické vyšetření zvířete

- Sonografie



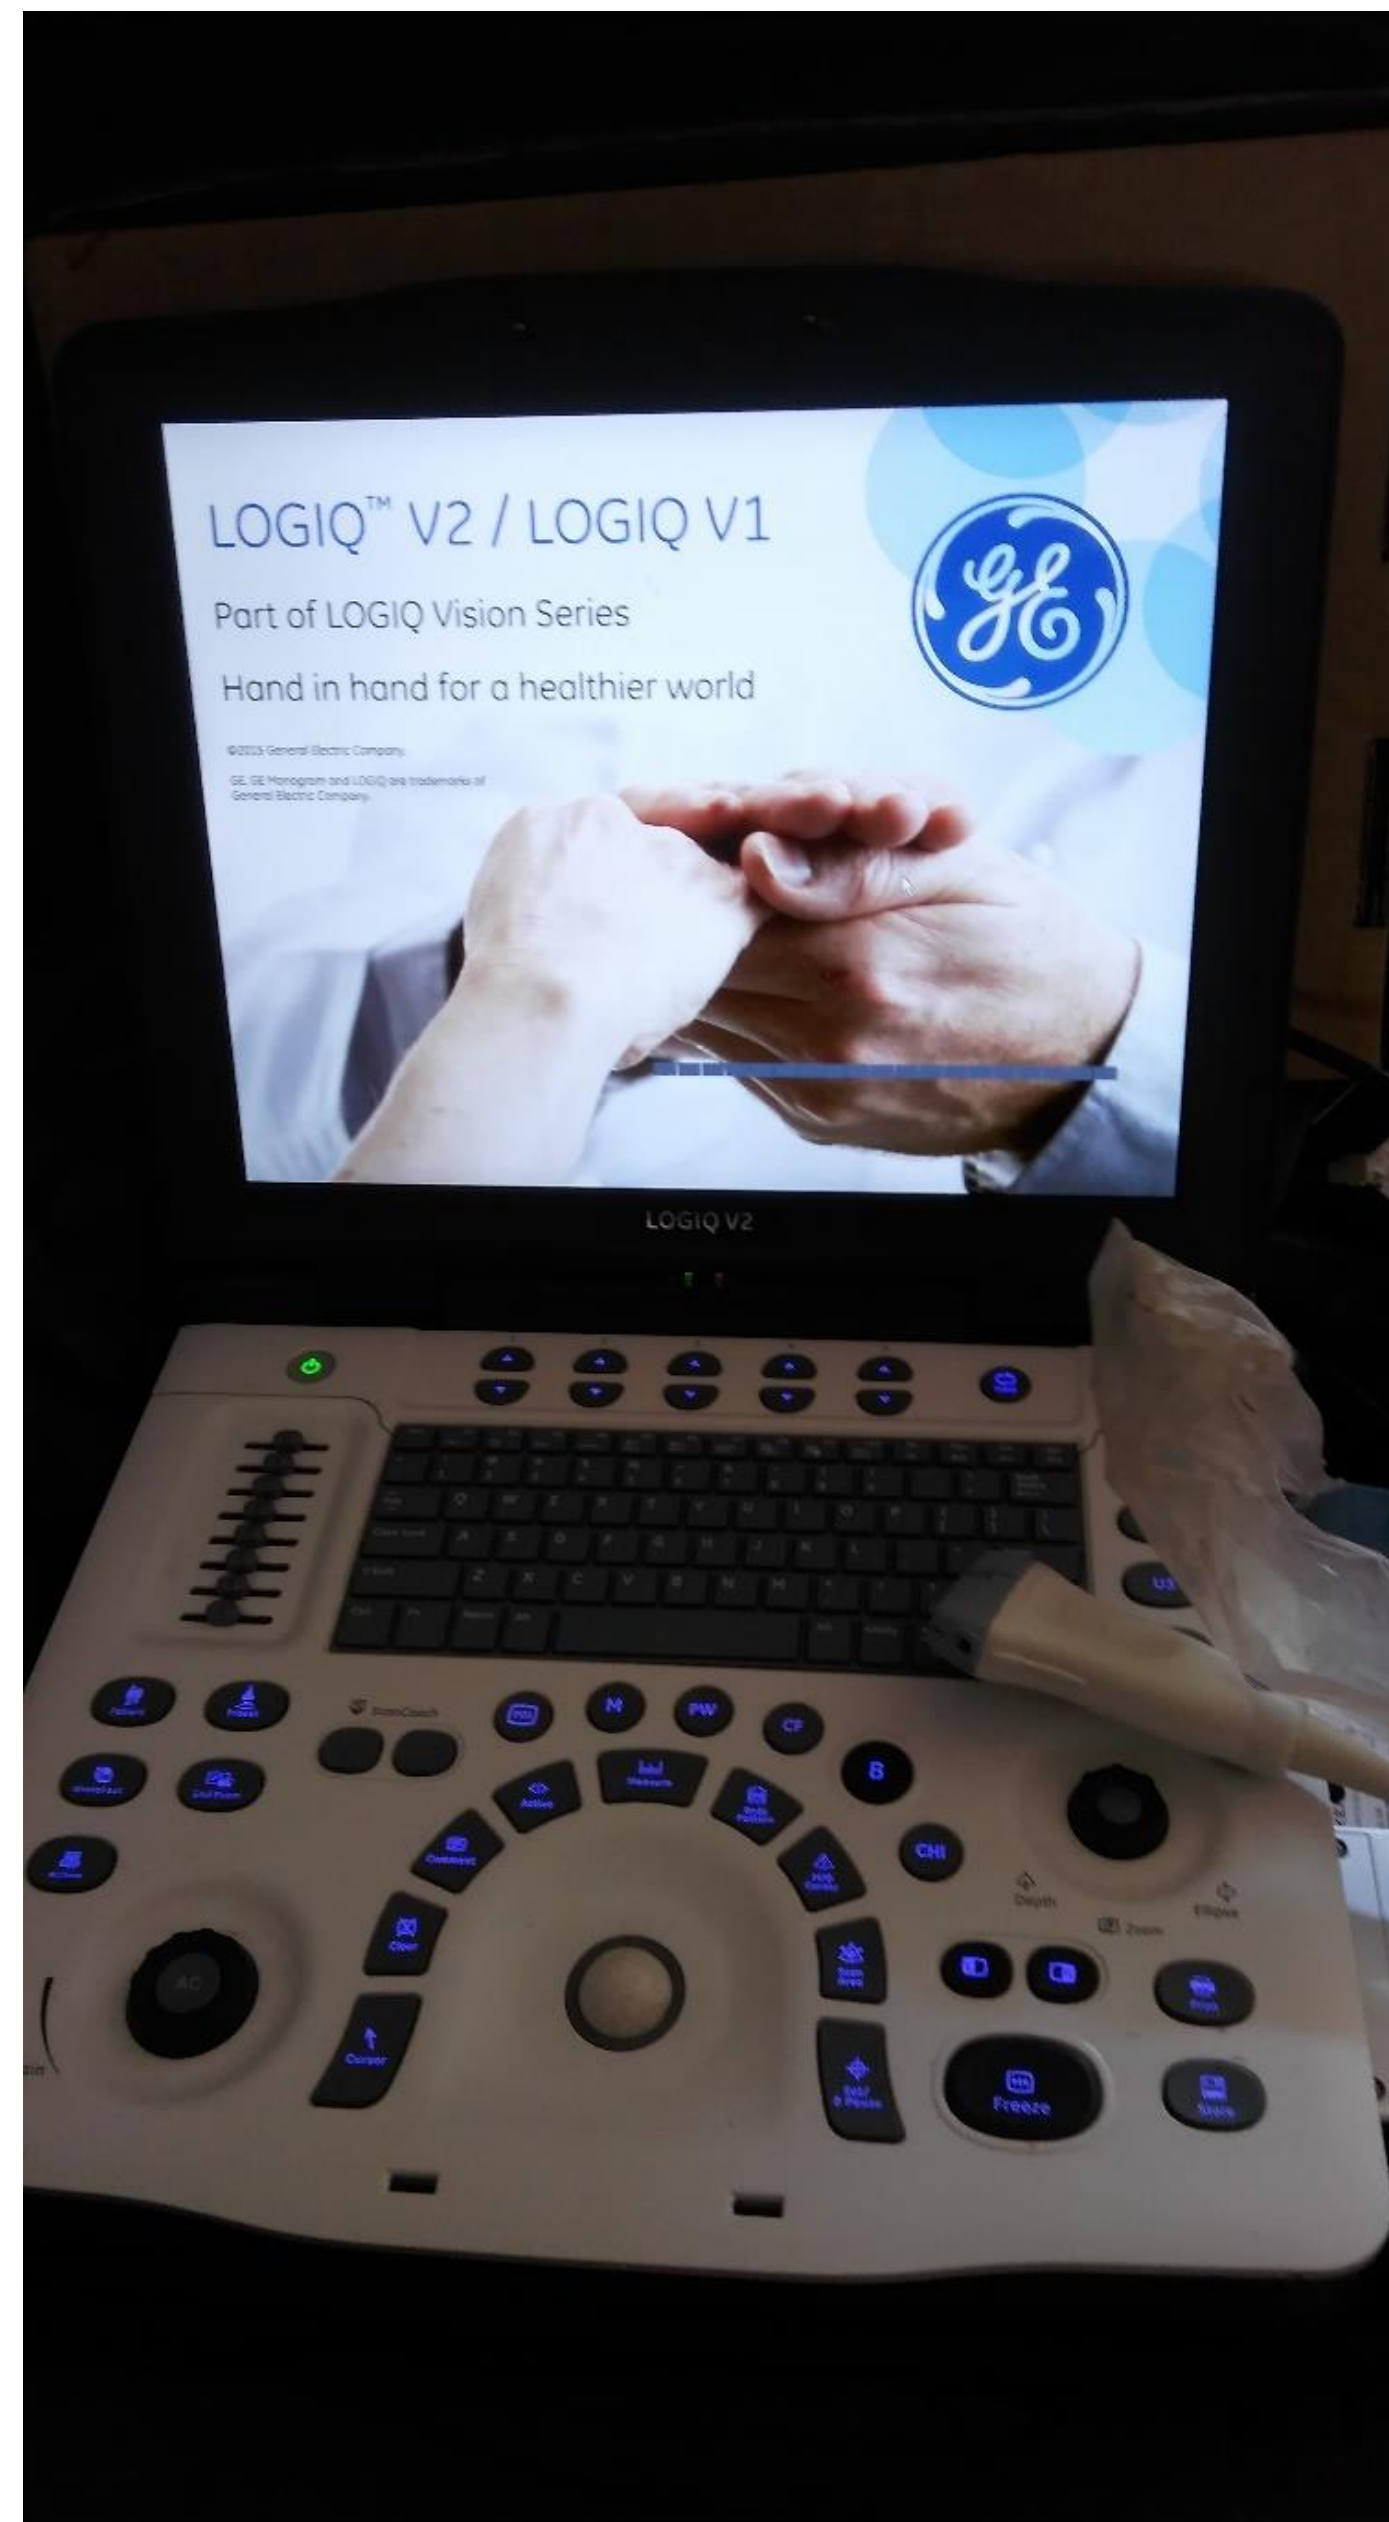

Příprava operačního pole před aplikací produktu

- Umytí betadinovým mýdlem




Příprava operačního pole před aplikací produktu

- Dezinfekce (Betadine)



Aplikace produktu

- Stříkačku s produktem mírně protřepat
- Odšroubovat sterilní zátku a místo ní nasadit sterilní jehlu
- Aplikace produktu v souladu s příbalovou informací

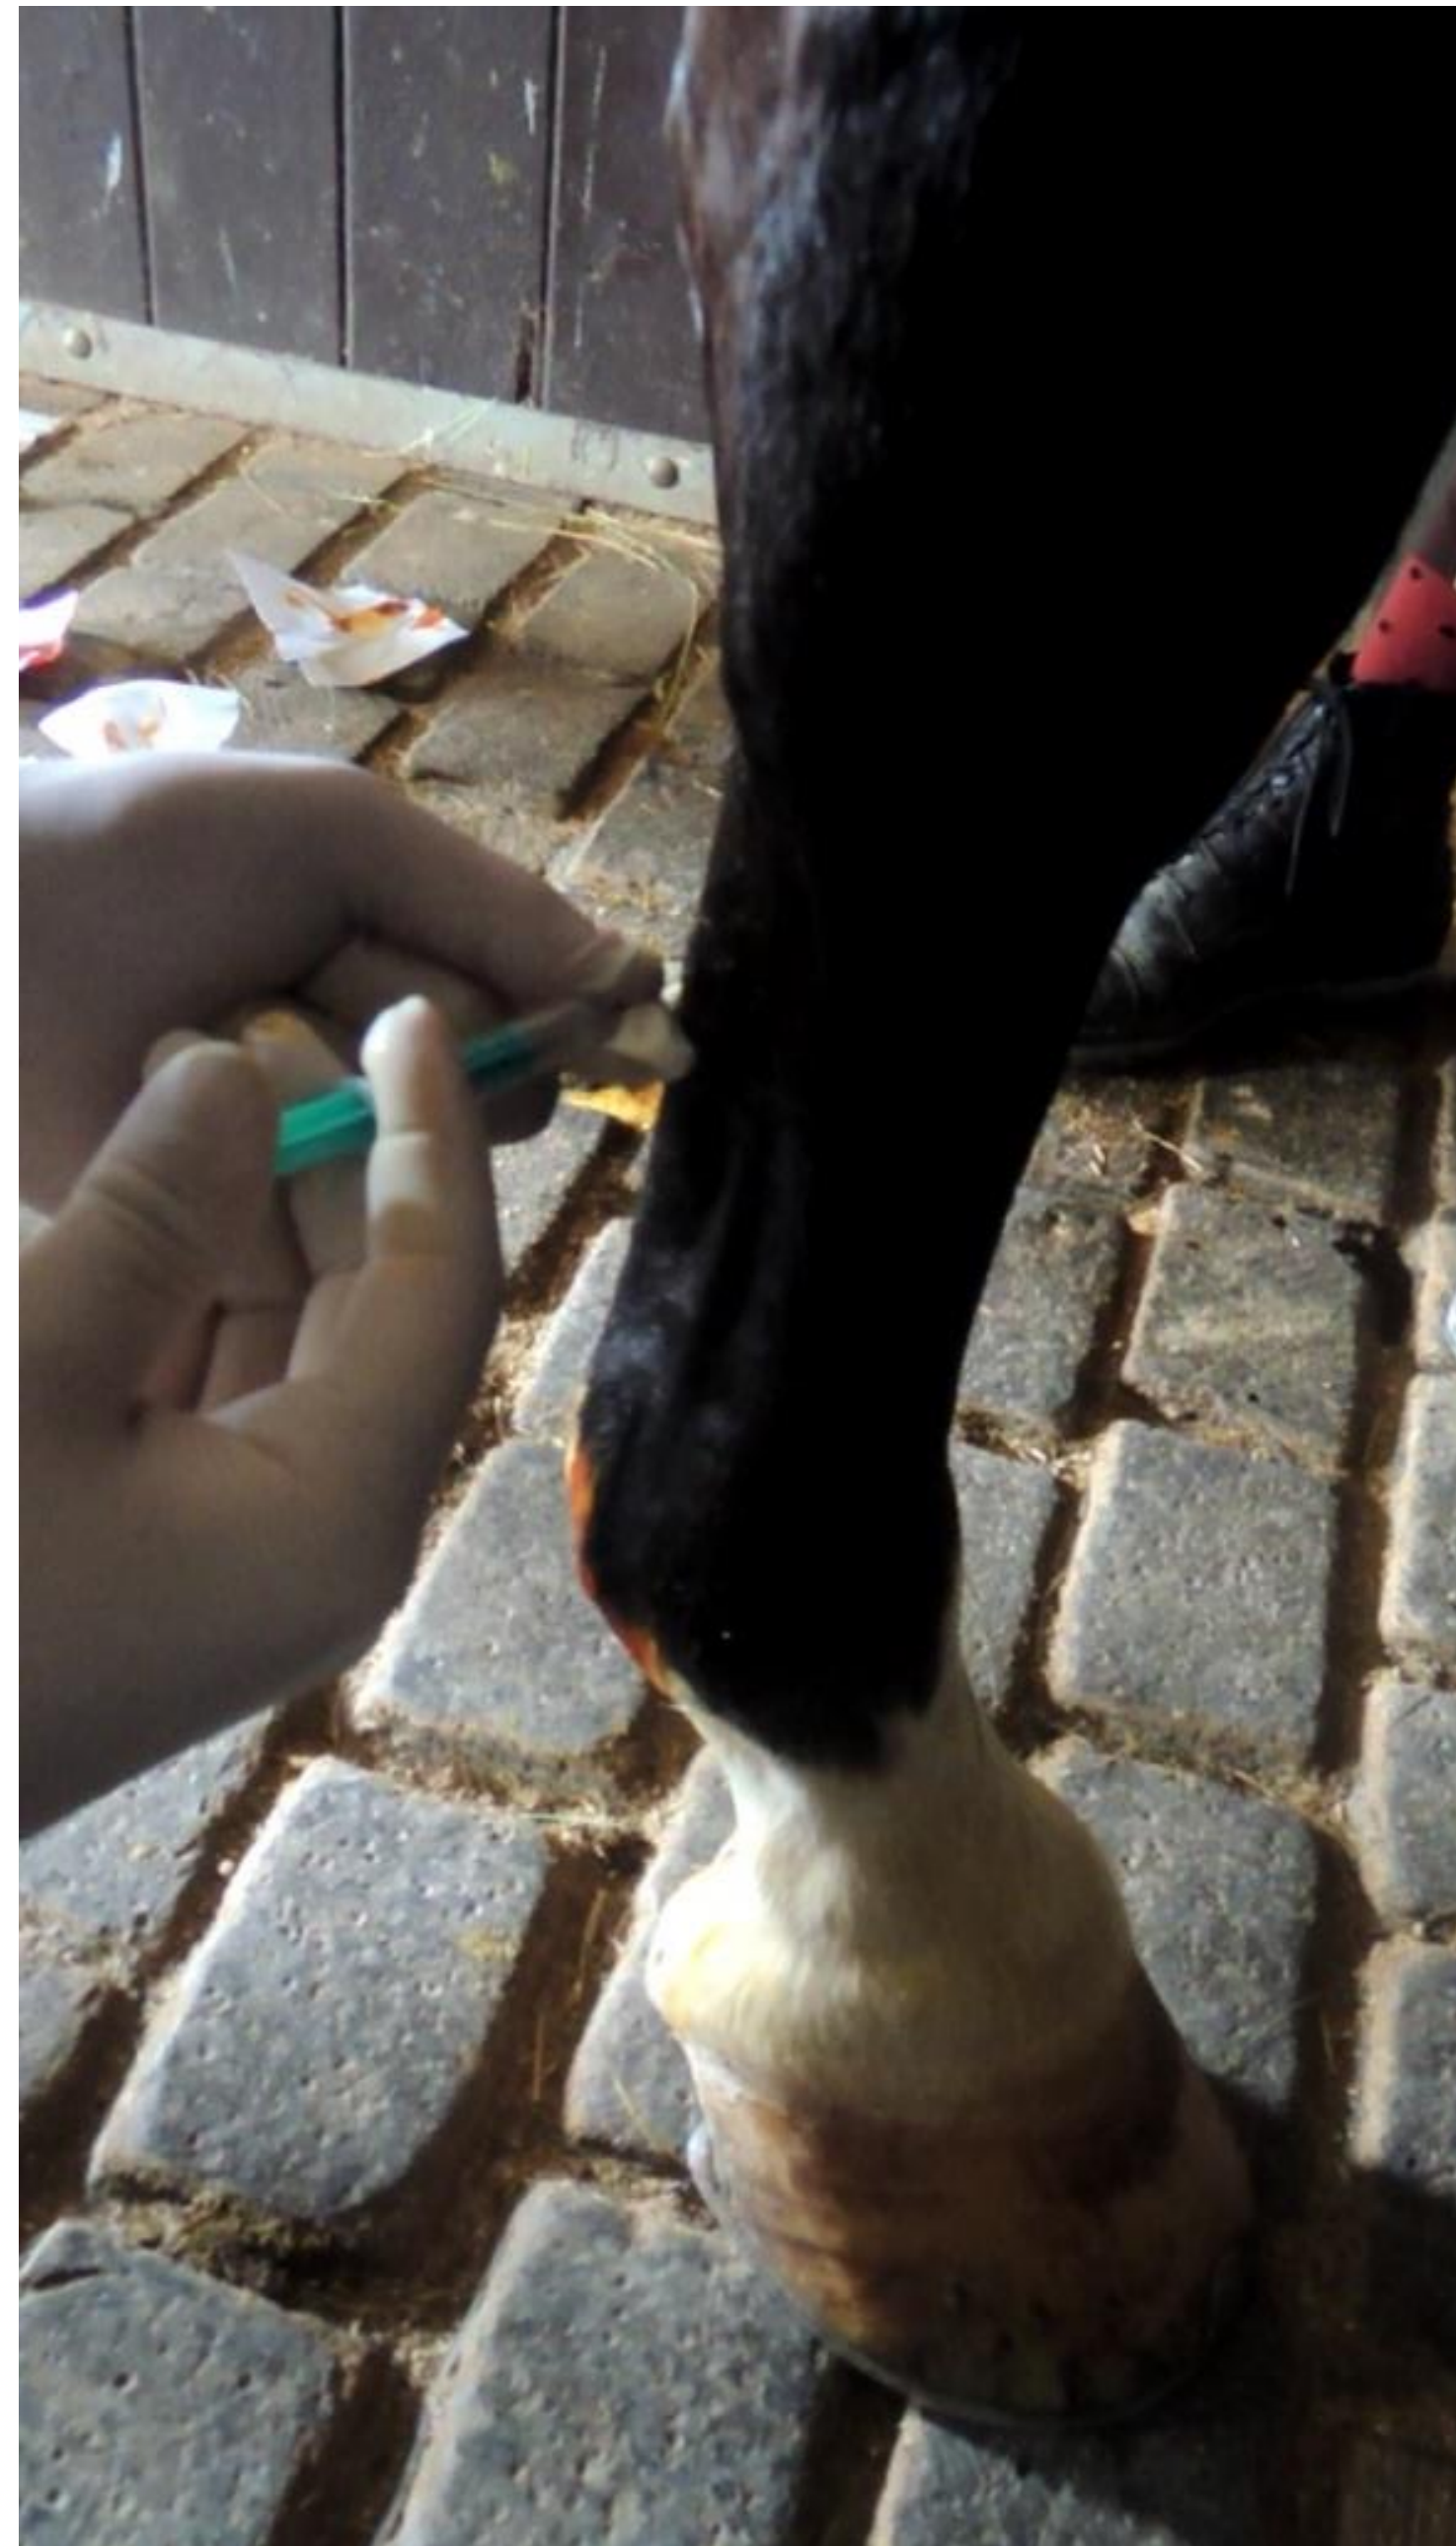

Ošetření po aplikaci



Vrácení zapůjčeného termoboxu a dataloggeru do Medicínského centra Praha (MCP)

- Nejpozději 48 hodin od jeho zapůjčení



Formuláře

- Spolu s produktem Vám byly předány formuláře „***Follow-up 1,2,3***“, které po uplynutí příslušného intervalu od aplikace produktu zašlete vyplněné zpět do Medicínského centra Praha.

- Formuláře: *Follow-up 1* (3 měsíce), *Follow-up 2* (1/2 roku), *Follow-up 3* (1 rok)

MEDICÍNSKÉ CENTRUM PRAHA

MEZI VODAMI 205/29, 143 00 PRAHA 4
T +420 270 003 562 / 564

Odborné dotazy:
MVDr. Miroslav Trunda +420 737 374 784

INFO@AVECELL.CZ

www.avecell.cz